


## Cepillo de Citoloxia

**Se utiliza endoscópicamente para obtener muestras de la mucosa del tejido del tracto gastrointestinal para exámen microscópico-histopatológico**

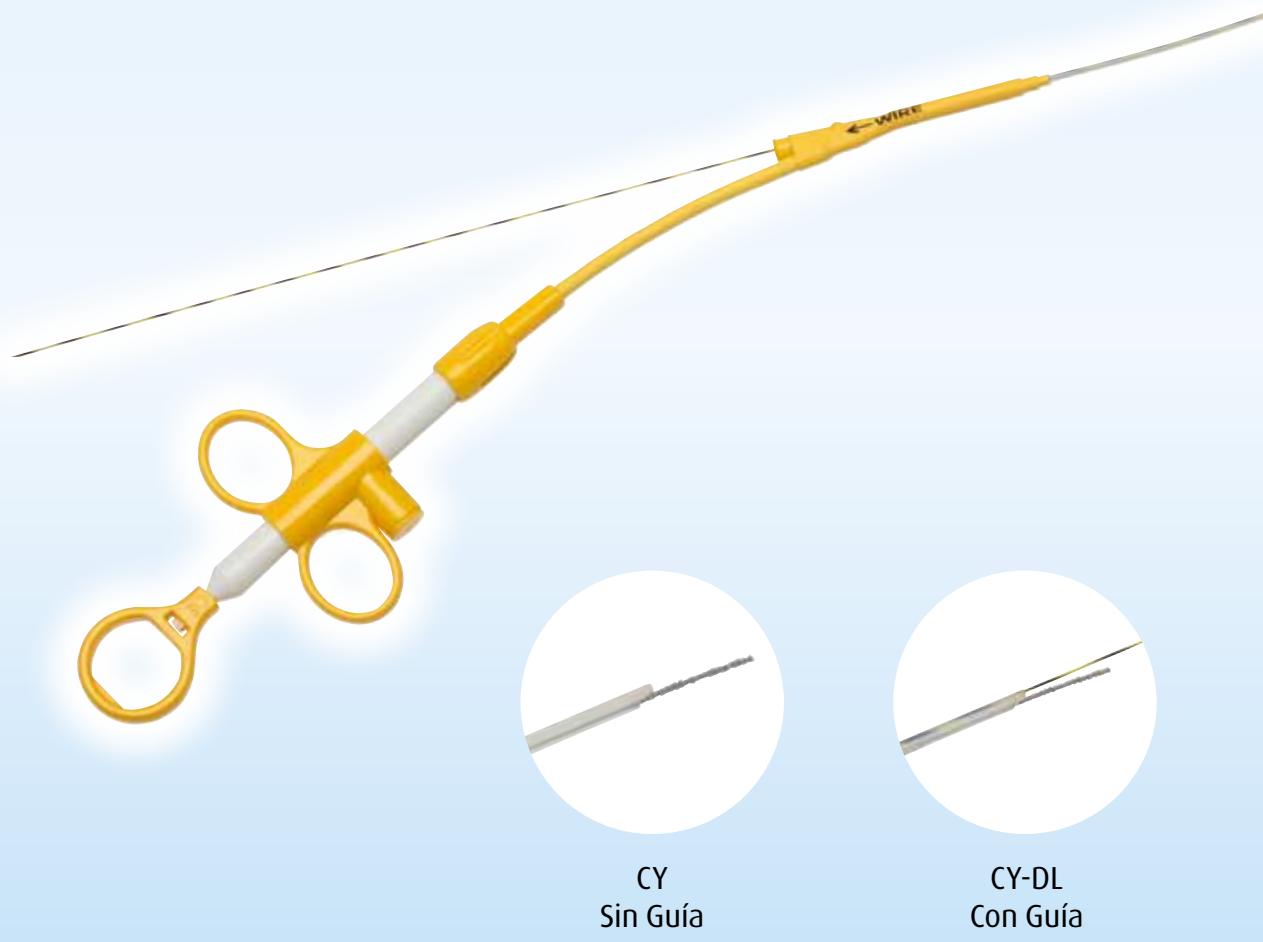

Art. No.	Guía	Longitud de Trabajo (cm)	Cana de Trabajo Ø (mm)
<b>CY</b>	0.032"	230	2.8
<b>CY-DL</b>	0.032"	230	2.8